



Z315000941375

副本

检验检测机构名称

检测报告

报告编号

日期

页码

页码

报告名称

页码

报告名称

报告名称

报告名称



1/1 100%



100%




100%

序号

参数

分析标准

检测

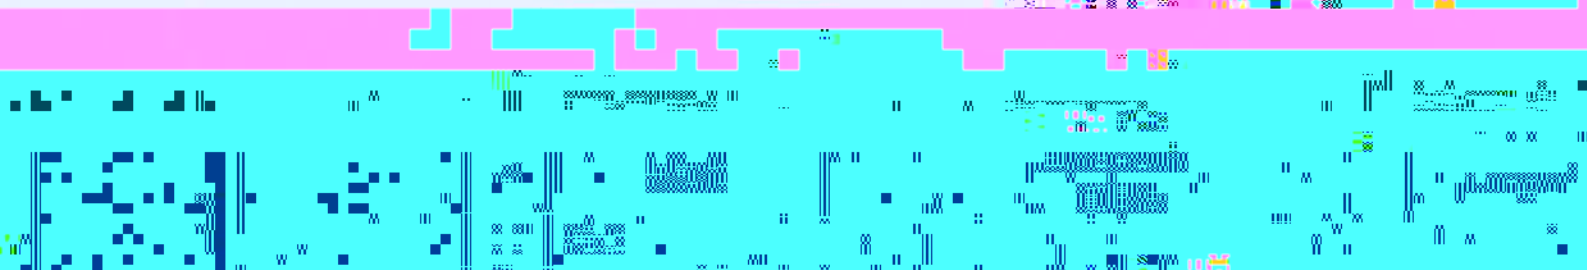

100%



100%



3. 检测仪器

表 1 检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
气相色谱仪	GC-2060	HL-001
液相色谱仪	LC-2060	HL-002
原子吸收光谱仪	AAS-2000	HL-003
紫外可见分光光度计	UV-2000	HL-004
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-AES	HL-005
气态重金属检测仪	GM-2000	HL-006
水质分析仪	QA-2000	HL-007
实验室天平	FA-105	HL-008
烘箱	101-1	HL-009
马弗炉	101-2	HL-010
超净工作台	CJZ-1000	HL-011
生物安全柜	BS-1000	HL-012
高压灭菌锅	1151	HL-013
离心机	8000	HL-014
振荡器	101	HL-015
培养箱	101	HL-016
显微镜	101	HL-017
电导率仪	101	HL-018
pH计	101	HL-019
溶解氧仪	101	HL-020
浊度仪	101	HL-021
氨氮检测仪	101	HL-022
总磷检测仪	101	HL-023
总氮检测仪	101	HL-024
COD检测仪	101	HL-025
BOD检测仪	101	HL-026
DO检测仪	101	HL-027
ORP检测仪	101	HL-028
电导率仪	101	HL-029
pH计	101	HL-030
溶解氧仪	101	HL-031
浊度仪	101	HL-032
氨氮检测仪	101	HL-033
总磷检测仪	101	HL-034
总氮检测仪	101	HL-035
COD检测仪	101	HL-036
BOD检测仪	101	HL-037
DO检测仪	101	HL-038
ORP检测仪	101	HL-039
电导率仪	101	HL-040
pH计	101	HL-041
溶解氧仪	101	HL-042
浊度仪	101	HL-043
氨氮检测仪	101	HL-044
总磷检测仪	101	HL-045
总氮检测仪	101	HL-046
COD检测仪	101	HL-047
BOD检测仪	101	HL-048
DO检测仪	101	HL-049
ORP检测仪	101	HL-050
电导率仪	101	HL-051
pH计	101	HL-052
溶解氧仪	101	HL-053
浊度仪	101	HL-054
氨氮检测仪	101	HL-055
总磷检测仪	101	HL-056
总氮检测仪	101	HL-057
COD检测仪	101	HL-058
BOD检测仪	101	HL-059
DO检测仪	101	HL-060
ORP检测仪	101	HL-061
电导率仪	101	HL-062
pH计	101	HL-063
溶解氧仪	101	HL-064
浊度仪	101	HL-065
氨氮检测仪	101	HL-066
总磷检测仪	101	HL-067
总氮检测仪	101	HL-068
COD检测仪	101	HL-069
BOD检测仪	101	HL-070
DO检测仪	101	HL-071
ORP检测仪	101	HL-072
电导率仪	101	HL-073
pH计	101	HL-074
溶解氧仪	101	HL-075
浊度仪	101	HL-076
氨氮检测仪	101	HL-077
总磷检测仪	101	HL-078
总氮检测仪	101	HL-079
COD检测仪	101	HL-080
BOD检测仪	101	HL-081
DO检测仪	101	HL-082
ORP检测仪	101	HL-083
电导率仪	101	HL-084
pH计	101	HL-085
溶解氧仪	101	HL-086
浊度仪	101	HL-087
氨氮检测仪	101	HL-088
总磷检测仪	101	HL-089
总氮检测仪	101	HL-090
COD检测仪	101	HL-091
BOD检测仪	101	HL-092
DO检测仪	101	HL-093
ORP检测仪	101	HL-094
电导率仪	101	HL-095
pH计	101	HL-096
溶解氧仪	101	HL-097
浊度仪	101	HL-098
氨氮检测仪	101	HL-099
总磷检测仪	101	HL-100
总氮检测仪	101	HL-101
COD检测仪	101	HL-102
BOD检测仪	101	HL-103
DO检测仪	101	HL-104
ORP检测仪	101	HL-105
电导率仪	101	HL-106
pH计	101	HL-107
溶解氧仪	101	HL-108
浊度仪	101	HL-109
氨氮检测仪	101	HL-110
总磷检测仪	101	HL-111
总氮检测仪	101	HL-112
COD检测仪	101	HL-113
BOD检测仪	101	HL-114
DO检测仪	101	HL-115
ORP检测仪	101	HL-116
电导率仪	101	HL-117
pH计	101	HL-118
溶解氧仪	101	HL-119
浊度仪	101	HL-120
氨氮检测仪	101	HL-121
总磷检测仪	101	HL-122
总氮检测仪	101	HL-123
COD检测仪	101	HL-124
BOD检测仪	101	HL-125
DO检测仪	101	HL-126
ORP检测仪	101	HL-127
电导率仪	101	HL-128
pH计	101	HL-129
溶解氧仪	101	HL-130
浊度仪	101	HL-131
氨氮检测仪	101	HL-132
总磷检测仪	101	HL-133
总氮检测仪	101	HL-134
COD检测仪	101	HL-135
BOD检测仪	101	HL-136
DO检测仪	101	HL-137
ORP检测仪	101	HL-138
电导率仪	101	HL-139
pH计	101	HL-140
溶解氧仪	101	HL-141
浊度仪	101	HL-142
氨氮检测仪	101	HL-143
总磷检测仪	101	HL-144
总氮检测仪	101	HL-145
COD检测仪	101	HL-146
BOD检测仪	101	HL-147
DO检测仪	101	HL-148
ORP检测仪	101	HL-149
电导率仪	101	HL-150
pH计	101	HL-151
溶解氧仪	101	HL-152
浊度仪	101	HL-153
氨氮检测仪	101	HL-154
总磷检测仪	101	HL-155
总氮检测仪	101	HL-156
COD检测仪	101	HL-157
BOD检测仪	101	HL-158
DO检测仪	101	HL-159
ORP检测仪	101	HL-160
电导率仪	101	HL-161
pH计	101	HL-162
溶解氧仪	101	HL-163
浊度仪	101	HL-164
氨氮检测仪	101	HL-165
总磷检测仪	101	HL-166
总氮检测仪	101	HL-167
COD检测仪	101	HL-168
BOD检测仪	101	HL-169
DO检测仪	101	HL-170
ORP检测仪	101	HL-171
电导率仪	101	HL-172
pH计	101	HL-173
溶解氧仪	101	HL-174
浊度仪	101	HL-175
氨氮检测仪	101	HL-176
总磷检测仪	101	HL-177
总氮检测仪	101	HL-178
COD检测仪	101	HL-179
BOD检测仪	101	HL-180
DO检测仪	101	HL-181
ORP检测仪	101	HL-182
电导率仪	101	HL-183
pH计	101	HL-184
溶解氧仪	101	HL-185
浊度仪	101	HL-186
氨氮检测仪	101	HL-187
总磷检测仪	101	HL-188
总氮检测仪	101	HL-189
COD检测仪	101	HL-190
BOD检测仪	101	HL-191
DO检测仪	101	HL-192
ORP检测仪	101	HL-193
电导率仪	101	HL-194
pH计	101	HL-195
溶解氧仪	101	HL-196
浊度仪	101	HL-197
氨氮检测仪	101	HL-198
总磷检测仪	101	HL-199
总氮检测仪	101	HL-200
COD检测仪	101	HL-201
BOD检测仪	101	HL-202
DO检测仪	101	HL-203
ORP检测仪	101	HL-204
电导率仪	101	HL-205
pH计	101	HL-206
溶解氧仪	101	HL-207
浊度仪	101	HL-208
氨氮检测仪	101	HL-209
总磷检测仪	101	HL-210
总氮检测仪	101	HL-211
COD检测仪	101	HL-212
BOD检测仪	101	HL-213
DO检测仪	101	HL-214
ORP检测仪	101	HL-215
电导率仪	101	HL-216
pH计	101	HL-217
溶解氧仪	101	HL-218
浊度仪	101	HL-219
氨氮检测仪	101	HL-220
总磷检测仪	101	HL-221
总氮检测仪	101	HL-222
COD检测仪	101	HL-223
BOD检测仪	101	HL-224
DO检测仪	101	HL-225
ORP检测仪	101	HL-226
电导率仪	101	HL-227
pH计	101	HL-228
溶解氧仪	101	HL-229
浊度仪	101	HL-230
氨氮检测仪	101	HL-231
总磷检测仪	101	HL-232
总氮检测仪	101	HL-233
COD检测仪	101	HL-234
BOD检测仪	101	HL-235
DO检测仪	101	HL-236
ORP检测仪	101	HL-237
电导率仪	101	HL-238
pH计	101	HL-239
溶解氧仪	101	HL-240
浊度仪	101	HL-241
氨氮检测仪	101	HL-242
总磷检测仪	101	HL-243
总氮检测仪	101	HL-244
COD检测仪	101	HL-245
BOD检测仪	101	HL-246
DO检测仪	101	HL-247
ORP检测仪	101	HL-248
电导率仪	101	HL-249
pH计	101	HL-250
溶解氧仪	101	HL-251
浊度仪	101	HL-252
氨氮检测仪	101	HL-253
总磷检测仪	101	HL-254
总氮检测仪	101	HL-255
COD检测仪	101	HL-256
BOD检测仪	101	HL-257
DO检测仪	101	HL-258
ORP检测仪	101	HL-259
电导率仪	101	HL-260
pH计	101	HL-261
溶解氧仪	101	HL-262
浊度仪	101	HL-263
氨氮检测仪	101	HL-264
总磷检测仪	101	HL-265
总氮检测仪	101	HL-266
COD检测仪	101	HL-267
BOD检测仪	101	HL-268
DO检测仪	101	HL-269
ORP检测仪	101	HL-270
电导率仪	101	HL-271
pH计	101	HL-272
溶解氧仪	101	HL-273
浊度仪	101	HL-274
氨氮检测仪	101	HL-275
总磷检测仪	101	HL-276
总氮检测仪	101	HL-277
COD检测仪	101	HL-278
BOD检测仪	101	HL-279
DO检测仪	101	HL-280
ORP检测仪	101	HL-281
电导率仪	101	HL-282
pH计	101	HL-283
溶解氧仪	101	HL-284
浊度仪	101	HL-285
氨氮检测仪	101	HL-286
总磷检测仪	101	HL-287
总氮检测仪	101	HL-288
COD检测仪	101	HL-289
BOD检测仪	101	HL-290
DO检测仪	101	HL-291
ORP检测仪	101	HL-292
电导率仪	101	HL-293
pH计	101	HL-294
溶解氧仪	101	HL-295
浊度仪	101	HL-296
氨氮检测仪	101	HL-297
总磷检测仪	101	HL-298
总氮检测仪	101	HL-299
COD检测仪	101	HL-300
BOD检测仪	101	HL-301
DO检测仪	101	HL-302
ORP检测仪	101	HL-303
电导率仪	101	HL-304
pH计	101	HL-305
溶解氧仪	101	HL-306
浊度仪	101	HL-307
氨氮检测仪	101	HL-308
总磷检测仪	101	HL-309
总氮检测仪	101	HL-310
COD检测仪	101	HL-311
BOD检测仪	101	HL-312
DO检测仪	101	HL-313
ORP检测仪	101	HL-314
电导率仪	101	HL-315
pH计	101	HL-316
溶解氧仪	101	HL-317
浊度仪	101	HL-318
氨氮检测仪	101	HL-319
总磷检测仪	101	HL-320
总氮检测仪	101	HL-321
COD检测仪	101	HL-322
BOD检测仪	101	HL-323
DO检测仪	101	HL-324
ORP检测仪	101	HL-325
电导率仪	101	HL-326
pH计	101	HL-327
溶解氧仪	101	HL-328
浊度仪	101	HL-329
氨氮检测仪	101	HL-330
总磷检测仪	101	HL-331
总氮检测仪	101	HL-332
COD检测仪	101	HL-333
BOD检测仪	101	HL-334
DO检测仪	101	HL-335
ORP检测仪	101	HL-336
电导率仪	101	HL-337
pH计	101	HL-338
溶解氧仪	101	HL-339
浊度仪	101	HL-340
氨氮检测仪	101	HL-341
总磷检测仪	101	HL-342
总氮检测仪	101	HL-343
COD检测仪	101	HL-344
BOD检测仪	101	HL-345
DO检测仪	101	HL-346
ORP检测仪	101	HL-347
电导率仪	101	HL-348
pH计	101	HL-349
溶解氧仪	101	HL-350
浊度仪	101	HL-351
氨氮检测仪	101	HL-352
总磷检测仪	101	HL-353
总氮检测仪	101	HL-354
COD检测仪	101	HL-355
BOD检测仪	101	HL-356
DO检测仪	101	HL-357
ORP检测仪	101	HL-358
电导率仪	101	HL-359
pH计	101	HL-360
溶解氧仪	101	HL-361
浊度仪	101	HL-362
氨氮检测仪	101	HL-363
总磷检测仪	101	HL-364
总氮检测仪	101	HL-365
COD检测仪	101	HL-366
BOD检测仪	101	HL-367
DO检测仪	101	HL-368
ORP检测仪	101	HL-369
电导率仪	101	HL-370
pH计	101	HL-371
溶解氧仪	101	HL-372
浊度仪	101	HL-373
氨氮检测仪	101	HL-374
总磷检测仪	101	HL-375
总氮检测仪	101	HL-376
COD检测仪	101	HL-377
BOD检测仪	101	HL-378
DO检测仪	101	HL-379
ORP检测仪	101	HL-380
电导率仪	101	HL-381
pH计	101	HL-382
溶解氧仪	101	HL-383
浊度仪	101	HL-384
氨氮检测仪	101	HL-385
总磷检测仪	101	HL-386
总氮检测仪	101	HL-387
COD检测仪	101	HL-388
BOD检测仪	101	HL-389
DO检测仪	101	HL-390
ORP检测仪	101	HL-391
电导率仪	101	HL-392
pH计	101	HL-393
溶解氧仪	101	HL-394
浊度仪	101	HL-395
氨氮检测仪	101	HL-396
总磷检测仪	101	HL-397
总氮检测仪	101	HL-398
COD检测仪	101	HL-399
BOD检测仪	101	HL-400
DO检测仪	101	HL-401
ORP检测仪	101	HL-402
电导率仪	101	HL-403
pH计	101	HL-404
溶解氧仪	101	HL-405
浊度仪	101	HL-406
氨氮检测仪	101	HL-407

4. 检测数据

4.1 有组织废气

表 3 有组织废气监测结果

采样时间	2024.2.23	采样点位	1#炉窑
------	-----------	------	------



4.2 污水


表 4 污水检测结果

采样时间	检测点位	检测项目	单位	检测结果		
				第一次	第二次	第三次
				24H0677SZ1001	24H0677SZ1002	24H0677SZ1003
2024.02.23	DW001 艺废云长渠 总渠 放口	总磷	mg/L	0.05	0.05	0.05

5.质控信息

5.1 质控措施


1. 采样及挥发性有机物 (以非甲烷总烃计) 3 个, 采样 1 天, 1 天 1 次, 每天采集运输空白 1 个, 共采集 1 个; 共检测有组织废气颗粒物 3 个, 采样 1 天, 1 次, 每天采集运输空白 1 个, 共采集 1 个; 共检测有组织废气

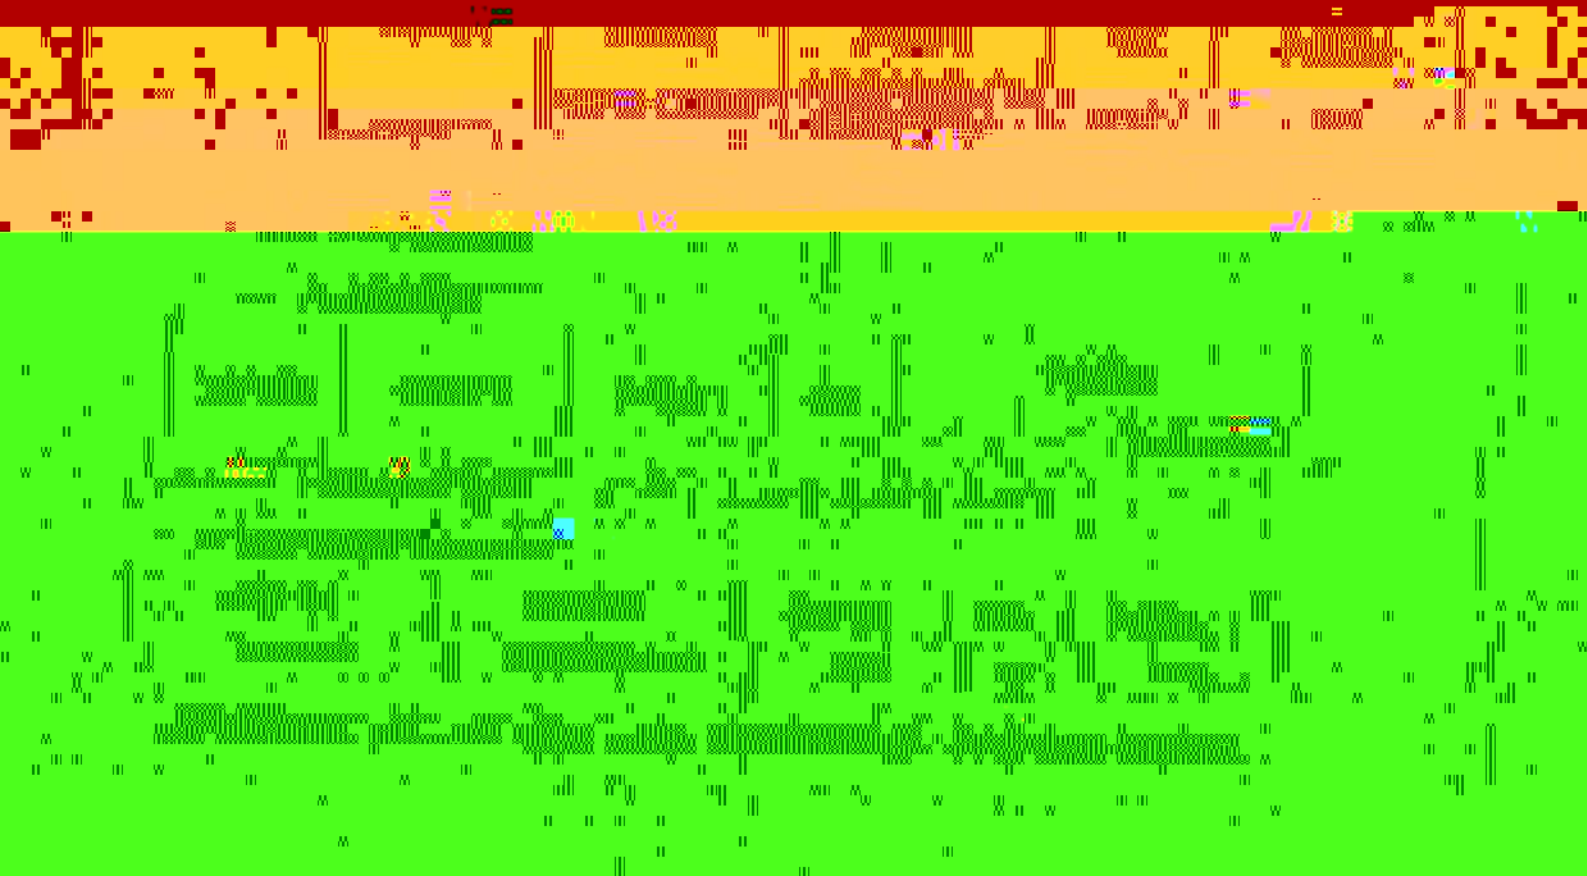

6. 现场照片



图 1 现场照片

3.本报告书改动无效，报告书盖有大华检测公司签字无效；未加盖公司检验检测专用章、骑缝章无效；未加盖  章仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

4.报告中检测项目带“*”代表“无能力分包（该检测项目公司无相应资质）”，检测项目带“#”代表“有能力分包”。

提出复核申请，逾期不予受理。

7.委托检测，系委托者自带检测样品送检，本公司不对检测样品来源负责。检测结果，仅对送检样品负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。

8.本检测报告一式三份，一份交委托单位，一份留存档案如检测单位有异议，

出